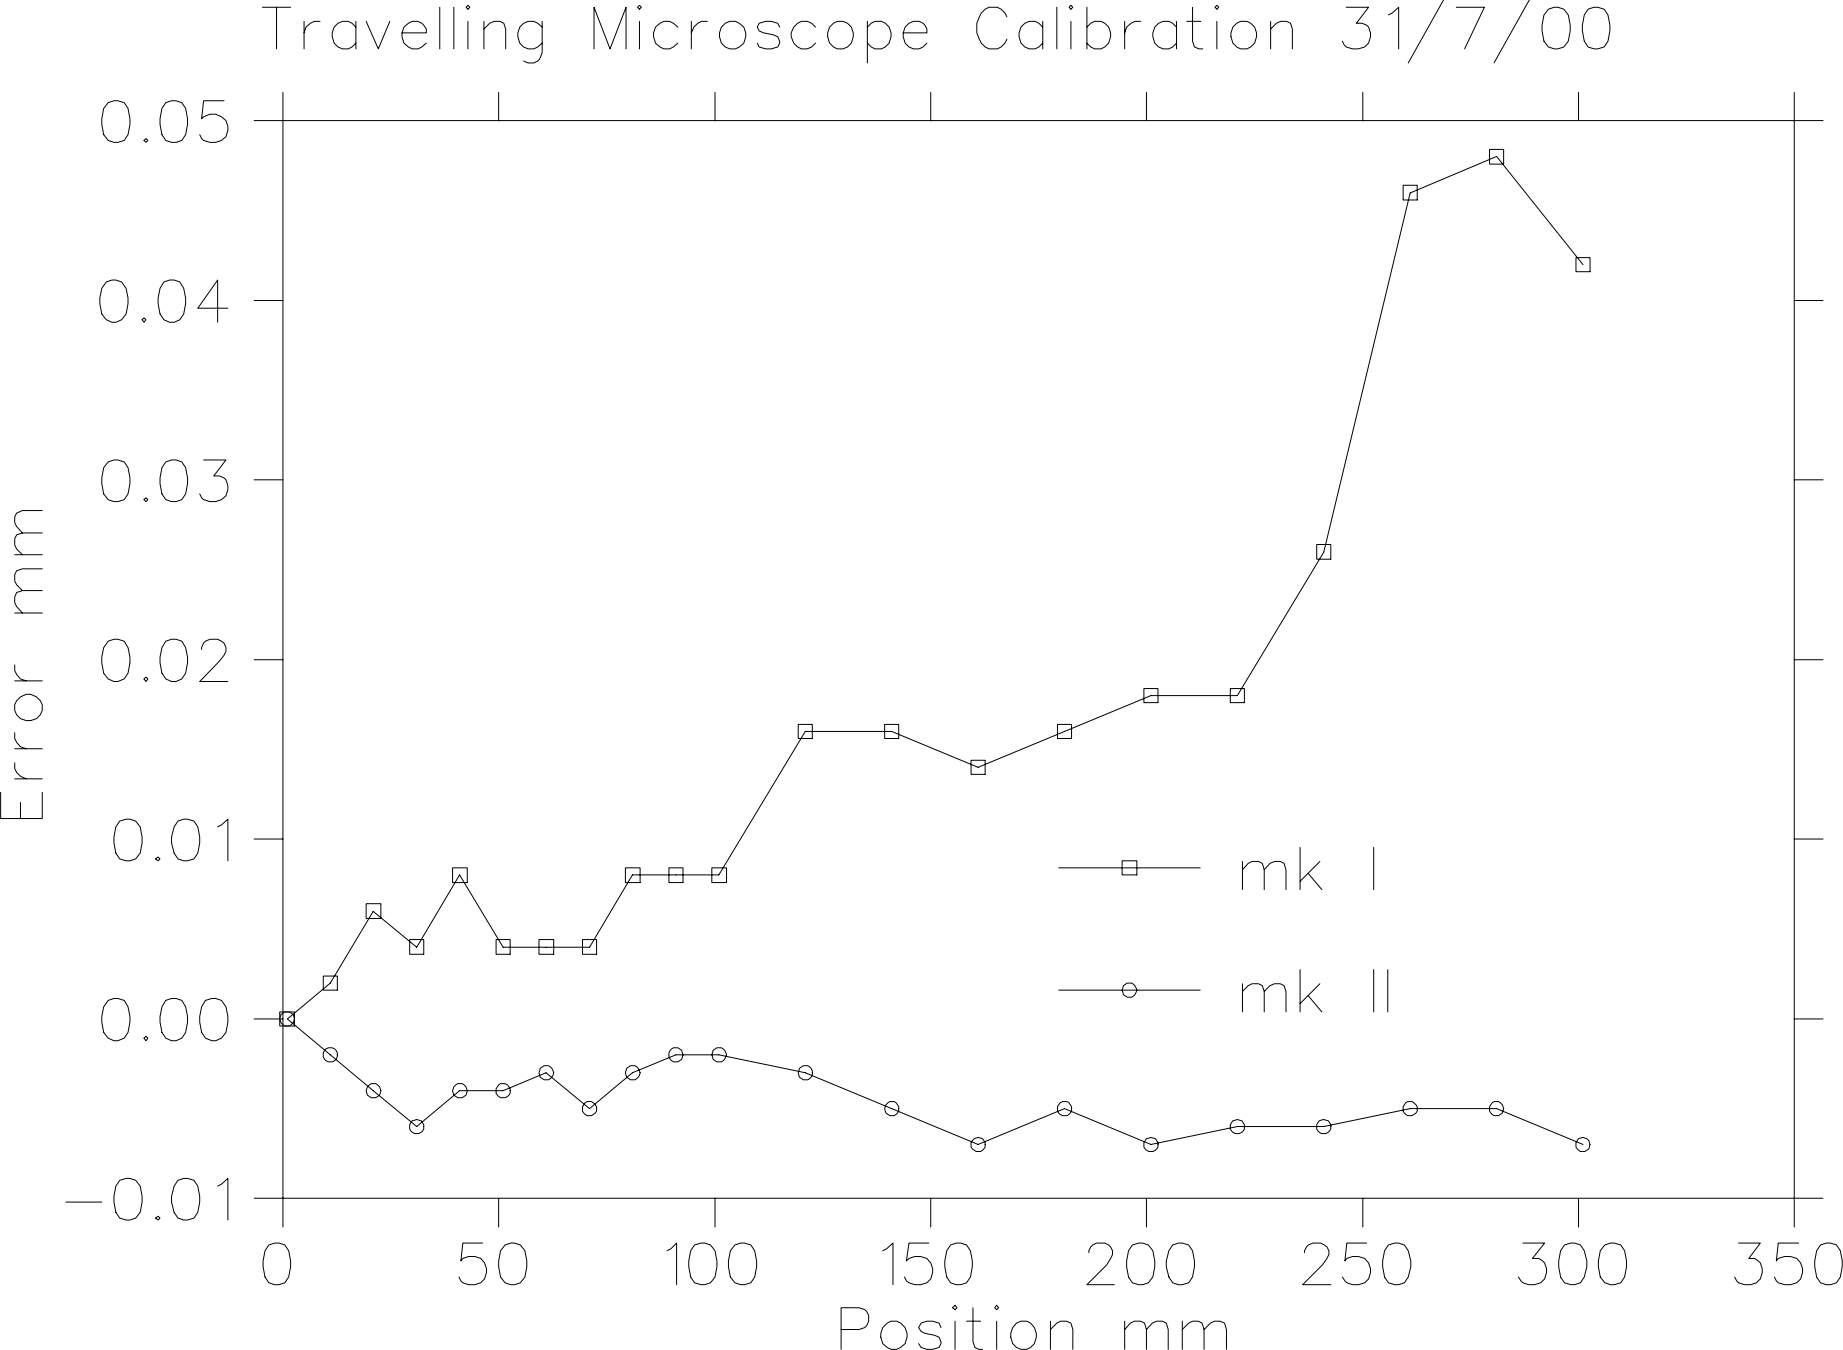
Travelling Microscope Calibration 31/7/00
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
Error mm
0
50
100
150
200
250
300
350
Position mm
mk I
mk II